

Osiguravanje sljedivosti mjerena zacrnjenja radiograma

Cupar, Filip

Master's thesis / Diplomski rad

2012

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:015856>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2025-02-25**

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

Filip Cupar

Zagreb, 2012.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

Mentor:

Prof. dr. sc. Josip Stepanić

Student:

Filip Cupar

Zagreb, 2012.

Izjava

Izjavljujem pod punom moralnom odgovornošću da sam diplomski rad izradio samostalno, isključivo znanjem stečenim na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, služeći se navedenim izvorima podataka i uz stručno vodstvo mentora prof. dr. sc. Josipa Stepanića, kojem se još jednom srdačno zahvaljujem.

Filip Cupar

U Zagrebu, studeni 2012.

Zahvale

Zahvaljujem se svojem mentoru, prof. dr. sc. Josipu Stepaniću na ukazanom povjerenju i pruženoj pomoći tijekom izrade diplomskog rada.

Također se zahvaljujem, prof. dr. sc. Damiru Markučiću, dipl. ing. Miroslavu Omeliću, mag. ing. Marku Rakvinu i Tomislavu Kezele na pruženoj pomoći i savjetima tijekom izvođenja preliminarnih mjerenja.

Od srca zahvaljujem svojoj obitelji na pruženoj potpori tijekom studija.

Filip Cupar



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite

Povjerenstvo za diplomske ispite studija strojarstva za smjerove:
proizvodno inženjerstvo, računalno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i menadžment, inženjerstvo
materijala i mehatronika i robotika

Sveučilište u Zagrebu	
Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa:	
Ur.broj:	

DIPLOMSKI ZADATAK

Student: **FILIP CUPAR** Mat. br.: 0035152982

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **OSIGURAVANJE SLJEDIVOSTI MJERENJA ZACRNJENJA RADIOGRAMA**

Naslov rada na engleskom jeziku: **ENSURING TRACEABILITY OF THE OPTICAL DENSITY MEASUREMENTS OF THE RADIOPHOTOGRAPH**

Opis zadatka:

Ispravnost provedbe nerazornih ispitivanja u industriji radiografskom metodom, između ostalog, dokazuje se i mjerjenjem postignutog optičkog zacrnjenja na odgovarajućim mjestima na snimljenome radiogramu pomoću mjerila zacrnjenja - denzitometra. Redovita periodična provjera i podešavanje denzitometra provodi se pomoću referentnih etalona zacrnjenja.

U radu je potrebno osmislit i provesti usporedbena mjerena zacrnjenja te ustanoviti značajnost pojedinih utjecajnih čimbenika na mjerene zacrnjenja s obzirom na problematiku osiguravanja ponovljivosti, obnovljivosti i sljedivosti rezultata mjerjenja. Posebnu pozornost potrebno je obratiti na utjecaj:

- starosti i općeg stanja referentnih etalona zacrnjenja,
- različitih tipova izvedbi denzitometra,
- pozadinskog osvjetljenja iluminatora.

Dobivene rezultate potrebno je analizirati sa stanovišta osiguranja kvalitete radiografskog ispitivanja, grafički prikazati te predložiti unaprijedenja uvriježenih postupaka provjere denzitometra.

Zadatak zadan:

13. rujna 2012.

Rok predaje rada:

15. studenog 2012.

Predviđeni datum obrane:

21. i 22. studenog 2012.

Zadatak zadao:

Prof. dr. sc. Josip Stepanić

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Franjo Cajner

SADRŽAJ

SADRŽAJ	I
POPIS SLIKA	II
POPIS TABLICA	III
SAŽETAK	IV
1. UVOD	1
2. Zacrnjenje	2
3. Oprema za provođenje mjerenja zacrnjenja	3
3.1. Izvor svjetlosti	3
3.2. Denzitometar	5
3.2.1. Digit-X (Xograph)	6
3.2.2. X-Rite 301X	6
3.2.3. SAKURA PDA – 85	7
3.3. Stepeničasti etaloni za mjerenje zacrnjenja	7
3.3.1. AGFA certificirani stepeničasti etalon - AGFA Structurix certified denstep	7
3.3.2. BAM – stepeničasti etalon zacrnjenja	9
4. Provođenje postupka mjerenja referentnih vrijednosti zacrnjenja	11
5. ZAKLJUČAK	39
6. PRILOZI	40
7. LITERATURA	41

POPIS SLIKA

- Slika 1. Iluminator
Slika 2. Princip mjerena denzitometrom
Slika 3. Denzitometar Digit-X
Slika 4. Denzitometar X-Rite 301X
Slika 5. Denzitometar Sakura PDA-85
Slika 6. AGFA Structurix certified denstep
Slika 7. BAM stepeničasti etalon zacrnjenja
Slika 8. Označavanje područja mjerena zacrnjenja na površini iluminatora
Slika 9. Grafički prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja (AGFA sa važećim certifikatom)
Slika 10. Usporedba referentnih vrijednosti etalona zacrnjenja sa vrijednostima zacrnjenja dobivenim mjeranjem zacrnjenja denzitometrom SAKURA PDA-85
Slika 11. Usporedba referentnih vrijednosti etalona zacrnjenja sa vrijednostima zacrnjenja dobivenim mjeranjem zacrnjenja denzitometrom Digit-X (Xograph)
Slika 12. Usporedba referentnih vrijednosti zacrnjenja (AGFA) i izmjerenih vrijednosti zacrnjenja (SAKURA PDA-85 i Digit-X)
Slika 13. Grafički prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja (AGFA sa ne važećim certifikatom)
Slika 14. Dozvoljeno odstupanje referentne vrijednosti etalona od referentnih vrijednosti dobivenih od proizvođača etalona
Slika 15. Prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja i vrijednosti dobivenih mjeranjem
Slika 16. Prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja i vrijednosti dobivenih mjeranjem
Slika 17. Grafički prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja (BAM)
Slika 18. Usporedba referentnih vrijednosti (BAM) i vrijednosti dobivenih mjeranjem
Slika 19. Područja mjerena zacrnjenja na jednoj stepenici etalona zacrnjenja
Slika 20. Usporedba rezultata mjerena zacrnjenja pri maksimalnom i smanjenom intezitetu svjetlosti iluminatora

POPIS TABLICA

- Tablica 1. Minimalno osvjetljenje zaslona iluminatora u ovisnosti o zacrnjenju radiograma
- Tablica 2. Referentne vrijednosti dobivene od proizvođača stepeničastog etalona (AGFA- sa važećim certifikatom)
- Tablica 3. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerenjem denzitometrom SAKURA PDA-85 (AGFA- sa važećim certifikatom)
- Tablica 4. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerenjem denzitometrom Digit-X (AGFA- sa važećim certifikatom)
- Tablica 5. Referentne vrijednosti dobivene od proizvođača stepeničastog etalona (AGFA- sa ne važećim certifikatom)
- Tablica 6. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerenjem denzitometrom X-Rite 301-X (AGFA- sa važećim certifikatom)
- Tablica 7. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerenjem denzitometrom X-Rite 301-X (AGFA- sa ne važećim certifikatom)
- Tablica 8. Referentne vrijednosti dobivene od proizvođača stepeničastog etalona (BAM)
- Tablica 9. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerenjem denzitometrom X-Rite 301-X
- Tablica 10. Rezultati mjerena za AGFA stepeničasti etalon sa važećim certifikatom
- Tablica 11. Rezultati mjerena za AGFA stepeničasti etalon sa ne važećim certifikatom
- Tablica 12. Rezultati mjerena za BAM stepeničasti etalon
- Tablica 13. Rezultati mjerena zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja sa ne važećim certifikatom pri maksimalnom intezitetu svjetlosti iluminatora
- Tablica 14. Rezultati mjerena zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja sa ne važećim certifikatom pri maksimalnom intezitetu svjetlosti iluminatora

SAŽETAK

Cilj provedbe mjerena zacrnjenja je doznati koji parametri utječu na dobiveni rezultat. Opisan je način na koji su provedena mjerena zacrnjenja, te su interpretirani dobiveni rezultati mjerena. Usporedbom rezultata mjerena na različitim tipovima denzitometara sa referentnim vrijednostima zacrnjenja dobivenim stepeničastog etalona zacrnjenja utvrđeno je kolika je točnost korištenih denzitometara. Stepeničasti etaloni zacrnjenja su od različitih proizvođača, te različitih starosti sa i bez važećeg certifikata. Mjerena su provedena i pri različitim intezitetima svjetlosti iluminatora kako bi se uočio eventualni utjecaj inteziteta svjetlosti iluminatora na dobivene rezultate mjerena zacrnjenja. Kao krajnji rezultat predložen je postupak za provjeru denzitometra.

Ključne riječi: denzitometar, iluminator, stepeničasti etalon zacrnjenja, zacrnjenje

1. UVOD

Radiografijom se otkrivaju unutrašnje greške pomoću ozračivanja dijelova rentgenskim tj. X-zrakama i γ -zrakama, njihovim prolaskom kroz ispitivani objekt. Prolaženjem rentgenskih zraka kroz materijal i grešku, zbog različite absorpcije, dolazi do različitog inteziteta zračivanja filmske emulzije filma koji se nalazi iza ispitnog objekta - indikacije. U cilju dobivanja radiograma ispitivani komad se stavlja između izvora zračenja tj. rendgenske cijevi i kasete s filmom na što manjoj udaljenosti. Ovisno o veličini indikacije, njene gustoće, lokacije i osjetljivosti filma ovisi i stupanj zacrnjenja.

S obzirom na atomski broj materijali imaju različitu sposobnost propuštanja zračenja, tako da manje propuštaju zrake ukoliko je njihova atomska težina veća. Ovo svojstvo koristi se pri ispitivanju. Stoga će sve pogreške, šupljine, pore, pukotine i slični defekti, biti jasno uočljivi na filmu koji je istovremeno trajni dokument kvalitete dobiven bez razaranja komada.

Zacrnjenje radiograma pri snimanju zavisi od apsorbcije metala, što znači da će svaka pogreška u proizvodu odnosno nehomogenost u materijalu biti pokazana na filmu različitim zacrnjenjem. Pri tome kvaliteta radiograma utoliko je bolja ukoliko je ozračen film kontrastniji i što je veća razlika između pojedinih granica kontura. Osjetljivost radiograma se cijeni veličinom najmanje pogreške koja je utvrđena na negativu pomoću indikatora [1].

2. Zacrnjenje

Logaritam odnosa inteziteta svjetlosti koja pada na određeni dio filma prema intezitetu svjetlosti koja prolazi kroz njega naziva se zacrnjenje. Uobičajena oznaka koja se upotrebljava za zacrnjenje je D.

$$D = \log_{10} \frac{I_o}{I}$$

gdje je:

I_o – intezitet svjetlosti koja pada na film

I – intezitet svjetlosti koja prolazi kroz film

3. Oprema za provođenje mjerena zacrnjenja

U sklopu ovog projekta provedena su mjerena u laboratoriju za nerazorna ispitivanja.

Oprema potrebna za provođenje mjerena zacrnjenja je:

- izvor svjetlosti (iluminator)
- denzitometar
- stepeničasti etaloni sa referentnim vrijednostima zacrnjenja

3.1. Izvor svjetlosti

U ovom projektu kao izvor svjetlosti korišten je iluminator (slika 1.).



Slika 1. Iluminator

Svjetlost dobivena iluminatorom koja služi za potrebe pregleda mora biti:

- jednolika, dakle vremenski konstantnog inteziteta
- difuzna, dakle jednoliko raspršena unutar prostora

Svjetlost iluminatora u principu treba biti bijela. Dozvoljeni interval valnih duljina je od 520 nm do 600 nm [2]. Raspršenost svjetlosti mora biti takva da oba oka promatrača primaju svjetlost sa svakog mjesta svjetleće površine.

Iluminator se sastoji od kućišta i zaslona za pregled radiograma koji je osvjetljen s unutrašnje strane. Kućište može sadržavati sustav za toplinsku zaštitu radiograma, dakle mogu i ne moraju biti ventilirana. Za gledanje mokrih radiograma osvjetljenje mora biti tako izvedeno da se spriječi prodiranje tekućina u kućište ukoliko dođe do kontakta radiograma i zaslona za pregled radiograma. [9]

Hlađenje u iluminatoru sprječava povišenje temperature kućišta i svjetleće površine iluminatora iznad 60 °C. Boljim odvodom topline osigurava se i dulji radni vijek iluminatora. Definirana je i gornja granica buke koju smije doseći iluminator u radu, npr. 40 dB [2].

Osvjetljenost zaslona za pregled radiograma ovisi o zacrnjenju radiograma. U tablici 1. preporučene su minimalne vrijednosti osvjetljenja zaslona iluminatora ovisno o zacrnjenju radiograma. [9]

Tablica 1. Minimalno osvjetljenje zaslona iluminatora u ovisnosti o zacrnjenju radiograma [9]


Zacrnjenje radiograma	Minimalno osvjetljenje zaslona cd/m ²
1	300
1,5	1000
2	3000
2,5	10 000
3	10 000
3,5	30 000
4	100 000
4,5	300 000

3.2. Denzitometar

Denzitometar je uređaj koji služi za mjerjenje zacrnjenja bilo koje točke na radiogramu. Tipovi denzitometra koji se najčešće koriste mjere područja površine 1mm^2 . Raspon vrijednosti zacrnjenja kreće se od D=0-5,00.

Kod denzitometra je važno periodičko podešavanje. Uz denzitometre dobivamo i etalone zacrnjenja koji služe za podešavanje uređaja. Podešavanje nužno mora biti izvršeno barem jedanput godišnje. Etaloni zacrnjenja se troše kada dolazi do pomicanja unutar prozirne kutije u kojoj se čuvaju, te prilikom samog rukovanja etalonom (npr. masnoća s prstiju). Do trošenja etalona dolazi i prilikom prislanjanja etalona zacrnjenja na iluminator prilikom mjerjenja zacrnjenja zbog povisene temperature svjetleće površine iluminatora, te prilikom izvođenja mjerjenja zacrnjenja denzitometrom odnosno pri kontaktu denzitometra i etalona zacrnjenja (utiskivanje, grebanje i sl.). Rok upotrebe nikad nije duži od 6 mjeseci. Stoga je AGFA razvila "Denstep" odnosno stepeničasti etalon zacrnjenja koji se isporučuje u posebnom pakiranju koje znatno produžuje vijek trajanja. Ti etaloni su certificirani i imaju garantni rok upotrebe od 4 godine do trenutka otvaranja pakiranja [3].

Kod industrijskih denzitometara se očekuje konstantna eksploatacija pa su izrađeni po standardima visoke kvalitete (24 satna eksploatacija). [3]

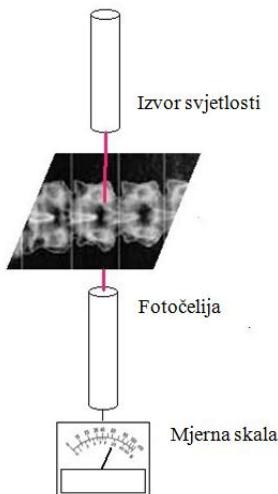

Slika 2. Princip mjerjenja denzitometrom [4]

Prilikom izvođenja mjerjenja zacrnjenja korištена su tri različita tipa denzitometra.

3.2.1. Digit-X (Xograph)

Digit-X je prenosiv i kompaktan uređaj za mjerjenje zacrnjenja u industrijskoj radiografiji. Rezultat mjerena se prikazuje na LCD zaslonu na dvije decimale.

Raspon zacrnjenja koji mjeri je od $D=0\text{--}4,00$. Promjer otvora (apertura) iznosi 3 mm($\sim 7 \text{ mm}^2$). Dimenzije uređaja su 210x60x40 mm, a težina uređaja je 175 g. [5]



Slika 3. Denzitometar Digit-X

3.2.2. X-Rite 301X

X-Rite 301X denzitometar ima raspon mjerena zacrnjenja od $D=0\text{--}5,00$, a rezultat se prikazuje na LCD zaslonu na dvije decimale. Njegova upotreba vrlo je jednostavna - "pritisni i očitaj". Promjer otvora (apertura) iznosi 3 mm. Dimenzije uređaja su 132x258x378 mm, težina uređaja je 3,8 kg. [6]



Slika 4. Denzitometar X-Rite 301X

3.2.3. SAKURA PDA – 85

Sakura PDA-85 je prenosiv uređaj za mjerjenje zacrnjenja u industrijskoj radiografiji. Rezultat mjerena se prikazuje na LCD zaslonu na dvije decimale. Promjer otvora (apertura) iznosi 3 mm.



Slika 5. Denzitometar Sakura PDA-85

3.3. Stepeničasti etaloni za mjerjenje zacrnjenja

Mjerena su provedena na dva stepeničasta etalona za mjerjenje zacrnjenja različitih proizvođača:

- AGFA stepeničasti etalon zacrnjenja (sa važećim i ne važećim certifikatom)
- BAM – stepeničasti etalon zacrnjenja

3.3.1. AGFA certificirani stepeničasti etalon - AGFA Structurix certified denstep

Identifikacijski broj: 9321023

Datum kalibriranja: rujan, 2010

Datum prvog korištenja: 11.01.2011.

1. Uporaba

Structurix certificirani stepeničasti etalon je etalon za kalibriranje optičkih prijenosnih denzitometara koji se koriste u industrijskoj radiografiji u području nerazornih ispitivanja.

2. Opis

Structurix certificirani stepeničasti etalon je izrađen na structurix D7 filmu koji se razvija na standardni način: temperatura razvijanja je 28 °C, vrijeme razvijanja je 100 sekundi (± 5 sekundi). Dimenzije etalona su 35x230 mm. Film je plave boje sa emulzijom na obje strane. Structurix certificirani stepeničasti etalon ima raspon zacrnjenja od $D=0\text{--}4,00$, sastoji se od 15 stepenica sa intervalima između stepenica od približno 0,3 (najniža vrijednost zacrnjenja je $<0,3$, a najviša vrijednost zacrnjenja je $> 3,9$).

3. Umjeravanje denzitometra

Vrijednosti zacrnjenja dobivenih od proizvođača izmjerene su kalibriranim optičkim prijenosnim denzitometrom Macbeth TR924 sa promjerom kružnog otvora od 3mm. Denzitometar je umjeravan metodama koje udovoljavaju uvjetima navedenim u ISO standardu za umjeravanje prijenosnih denzitometara, prema ANSI PH2.19-1990 i ISO 5-2:1991 "Mjerenje zacrnjenja- geometrijski uvjeti za prijenosne denzitometre" i prema ANSI PH2.18 i ISO 5-3:1984 "Mjerenje zacrnjenja- spektralni uvjeti". Mjerenja su provedena u centru svake pojedine stepenice. Ukupna procijenjena nesigurnost (u kombinaciji točnosti i preciznosti sa pouzdanošću od 95%) što znači da su vrijednosti zacrnjenja dane u tablici $\pm 0,022$ ili 2,2 %, ovisno o tome što je veće.

4. Trajnost

Trajnost stepeničastog etalona ovisi o načinu skladištenja i načinu rukovanja. Stepeničasti etalon je zapakiran u vodootpornu ambalažu, te je do trenutka otvaranja zaštićen i od grebanja i abrazije. Garancija ne otvorenog pakiranja iznosi 4 godine od datuma certificiranja etalona.

5. Životni vijek korištenja

Etalon se može koristiti 24 mjeseca od dana otvaranja pakiranja ili drugačije ako je tako navedeno u uputama. Stepeničasti etalon mora biti uskladišten na mračnom, hladnom i suhom mjestu. [7]



Slika 6. AGFA Structurix certified denstep

3.3.2. BAM – stepeničasti etalon zacrnjenja

BAM - državni zavod za istraživanje i ispitivanje materijala - Njemačka

Identifikacijski broj: 190298015

Umjeravano prema PTB (Njemački institut za fiziku i tehniku)

Datum kalibriranja: 19.02.1998.

Kalibracijski broj: 3598PTB96

Tolerancija: < 0,05 absolutno

Primjena:

Podešavanje uređaja za mjerjenje zacrnjenja (denzitometra) za industrijsku radiografiju u rasponu zacrnjenja od D= 0,3-5,00

Mjerenja se moraju provoditi na udaljenosti od minimalno 1,5 mm od ruba mjernih područja kako bi izmjerene vrijednosti zacrnjenja bile iste kao i one referentne vrijednosti zacrnjenja dobivenih od proizvođača. Da bi mjerena bila ispravno provedena emulzijski sloj etalona ne smije biti oštećen.

Skladištenje:

Stepeničasti etalon zacrnjenja mora biti skladišten na hladnom, suhom i tamnom mjestu kako bi se izbjeglo prerano starenje. [8]



Slika 7. BAM stepeničasti etalon zacrnjenja

4. Provodenje postupka mjerena referentnih vrijednosti zacrnjenja

Za provođenje postupka mjerena referentnih vrijednosti zacrnjenja moralo se osigurati da se zacrnjenje na stepeničastom etalonu zacrnjenja mjeri uvijek na istom mjestu na površini iluminatora budući da osvjetljenje, u praksi, ne mora biti jednoliko po cijeloj površini iluminatora. Time se postiglo da se sve "stepenice" zacrnjenja mjere pri istom intezitetu osvjetljenja i eliminirao se jedan od utjecaja na dobivene rezultate mjerena. To se osiguralo na način da se na površini iluminatora označi područje u kojem se provode mjerena svake "stepenice" zacrnjenja. To područje označeno je papirnom ljepljivom trakom kako ne bi došlo do oštećenja osvjetljene površine što je prikazano na slici 8. Dimenzija označenog područja je 35x15 mm što odgovara dimenzijama same "stepenice" zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja. Pri izvođenju mjerena intezitet osvjetljenja na iluminatoru bio je maksimalan.



Slika 8. Označavanje područja mjerena zacrnjenja na površini iluminatora

Mjerena su započeta na referentnom stepeničastom etalonu AGFA Structurix certified denstep sa još uvijek važećim certifikatom. Podešavanje denzitometra izvršeno je ili pri promjeni uređaja ili pri promjeni stepeničastog etalona, ovisno o tome koja promjena je prije nastupila, što znači da podešavanje nije izvršavano pri izvođenju svakog pojedinog mjerena zacrnjenja. Nakon izvršenog mjerena jednim denzitometrom uređaj je ugašen dok se pri svakom novom korištenju uređaj ponovno uključio i podesio. Podešavanje denzitometra izvodi se na način da se denzitometar prisloni na svjetleću površinu iluminatora pri intezitetu osvjetljenja pri kojem se izvodi mjerena zacrnjenja te se denzitometar podesi na nulu (tipka

za podešavanje). Mjerenja su izvođena slučajnim redoslijedom što znači da je neka od "stepenica" zacrnjenja možda bila izmjerena i tri puta dok neka nije ni jedanput izmjerena, ali ista "stepenica" zacrnjenja nikad nije mjerena dvaput za redom.


Referentne vrijednosti dobivene od proizvođača stepeničastog etalona sa važećim certifikatom (AGFA) prikazane su u tablici 2.

Tablica 2. Referentne vrijednosti dobivene od proizvođača stepeničastog etalona (AGFA- sa važećim certifikatom)

AGFA br. 9321023	
Stepenica	Referentna vrijednost
STEP 0	0.147
STEP 1	0.294
STEP 2	0.588
STEP 3	0.889
STEP 4	1.190
STEP 5	1.490
STEP 6	1.800
STEP 7	2.090
STEP 8	2.380
STEP 9	2.690
STEP 10	2.980
STEP 11	3.280
STEP 12	3.560
STEP 13	3.850
STEP 14	4.140

Referentne vrijednosti zacrnjenja iz tablice 2. grafički su prikazane na grafu 1.

Zacrnjenje (D)

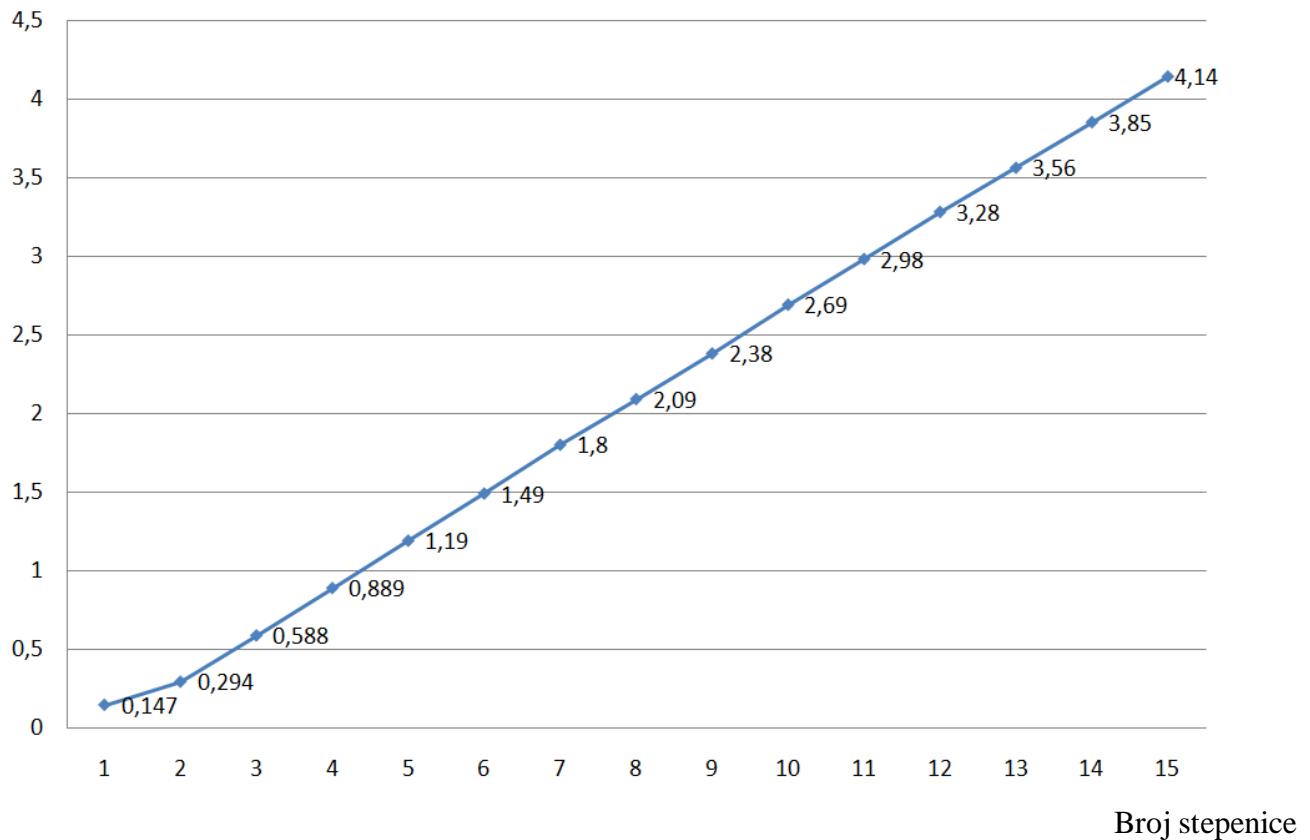

Slika 9. Grafički prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja (AGFA sa važećim certifikatom)


Iz grafa na slici 9. vidljivo je da se raspon od najniže vrijednosti zacrnjenja do najviše vrijednosti zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja mjenja linearno sa intervalima između stepenica od približno 0,3.

Vrijednosti zacrnjenja dobivenih od proizvođača stepeničastog etalona zacrnjenja uspoređene su sa vrijednostima zacrnjenja dobivenim mjeranjem tog istog etalona sa dva različita tipa denzitometra. Mjerena su provedena denzitometrom SAKURA PDA-85 čiji su rezultati mjeranja prikazani u tablici 3. i denzitometrom Digit-X (Xograph) čije su vrijednosti dobivene mjeranjem zacrnjenja prikazane u tablici 4.

Tablica 3. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerjenjem denzitometrom SAKURA PDA-85 (AGFA- sa važećim certifikatom)

SAKURA PDA-85							
Stepenica	1.mjerenje	2.mjerenje	3.mjerenje	Srednja vrijednost	Referentna vrijednost	Razlika referentne i srednje vrijednosti	Δ (%)
STEP 1	0.33	0.32	0.34	0.330	0.294	0.036	12.2
STEP 2	0.65	0.64	0.65	0.647	0.588	0.059	10
STEP 3	0.95	0.96	0.95	0.953	0.889	0.064	7.2
STEP 4	1.27	1.25	1.28	1.267	1.190	0.077	6.4
STEP 5	1.55	1.57	1.57	1.563	1.490	0.073	4.9
STEP 6	1.87	1.87	1.88	1.873	1.800	0.073	4.1
STEP 7	2.18	2.16	2.17	2.170	2.090	0.08	3.8
STEP 8	2.45	2.46	2.46	2.457	2.380	0.077	3.2
STEP 9	2.78	2.77	2.78	2.777	2.690	0.087	3.2
STEP 10	3.08	3.06	3.10	3.080	2.980	0.1	3.4
STEP 11	3.36	3.35	3.37	3.360	3.280	0.08	2.4
STEP 12	3.63	3.63	3.66	3.640	3.560	0.08	2.25
STEP 13	3.90	3.91	3.91	3.907	3.850	0.057	1.5
STEP 14	4.18	4.19	4.18	4.183	4.140	0.043	1

Zacrnjenje (D)

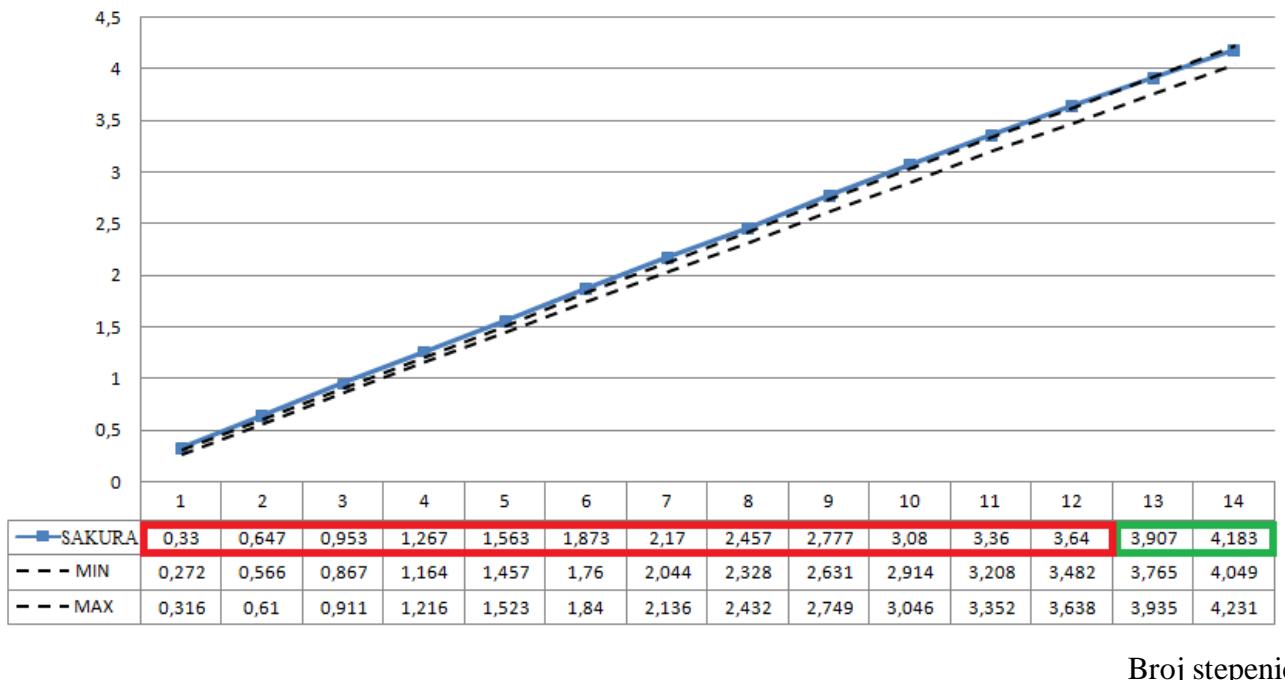

Slika 10. Usporedba referentnih vrijednosti etalona zacrnjenja sa vrijednostima zacrnjenja dobivenim mjeranjem zacrnjenja denzitometrom SAKURA PDA-85

Iz grafa na slici 10. vidljivo je da su samo rezultati mjeranja zacrnjenja 13. i 14. stepenice unutar dozvoljenog odstupanja. Budući da su mjeranja zacrnjenja izvođena na etalonu zacrnjenja sa važećim certifikatom može se zaključiti da denzitometar SAKURA PDA-85 nije točan. U prvom retku tablice ispod grafa prikazane su srednje vrijednosti zacrnjenja stepenica etalona dobivene nakon izvođenja po tri mjeranja na svakoj stepenici. U drugom i trećem retku prikazane su minimalne i maksimalne vrijednosti dozvoljenog odstupanja stepeničastog etalona zacrnjenja od referentnih vrijednosti dobivenih od proizvođača etalona što je na grafu prikazano iscrtkanim linijama. Crvenom bojom označeni su rezultati koji su izvan tolerancijskog polja, a zelenom bojom označeni su rezultati mjeranja koji se nalaze unutar tolerancijskog polja.


Potrebno je napomenuti da u obzir nije uzeto dozvoljeno odstupanje denzitometra SAKURA PDA-85. S obzirom da rezultati mjerena vrlo malo odstupaju od dozvoljenog, uvezši u obzir i toleranciju samog denzitometra gotovo bi svi rezultati bili unutar zadanih tolerancija.

Tablica 4. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjeranjem denzitometrom Digit-X (Xograph) (AGFA – sa važećim certifikatom)

Digit-X (Xograph)							
Stepenica	1.mjerenje	2.mjerenje	3.mjerenje	Srednja vrijednost	Referentna vrijednost	Razlika referentne i srednje vrijednosti	Δ (%)
STEP 1	0.30	0.30	0.30	0.300	0.294	0.006	2
STEP 2	0.59	0.61	0.62	0.607	0.588	0.019	3.2
STEP 3	0.93	0.94	0.94	0.937	0.889	0.048	5.4
STEP 4	1.25	1.26	1.27	1.260	1.190	0.07	5.9
STEP 5	1.55	1.57	1.58	1.567	1.490	0.077	5.2
STEP 6	1.88	1.89	1.90	1.890	1.800	0.09	5
STEP 7	2.16	2.18	2.20	2.180	2.090	0.09	4.3
STEP 8	2.47	2.48	2.49	2.480	2.380	0.1	4.2
STEP 9	2.79	2.80	2.80	2.797	2.690	0.107	4
STEP 10	3.07	3.11	3.11	3.097	2.980	0.117	3.9
STEP 11	3.38	3.40	3.40	3.393	3.280	0.113	3.4
STEP 12	3.66	3.67	3.69	3.673	3.560	0.113	3.2
STEP 13	3.96	3.98	3.98	3.973	3.850	0.123	3.2
STEP 14	4.21	4.21	4.22	4.213	4.140	0.073	1.8

Denzitometar Digit-X (Xograph) ima raspon mjeranja zacrnjenja od 0 do 4 što bi značilo da vrijednost zacrnjenja 14. stepenice etalona zacrnjenja nije vjerodostojna zbog toga što je vrijednost zacrnjenja te stepenice veća od 4.

Zacrnjenje (D)

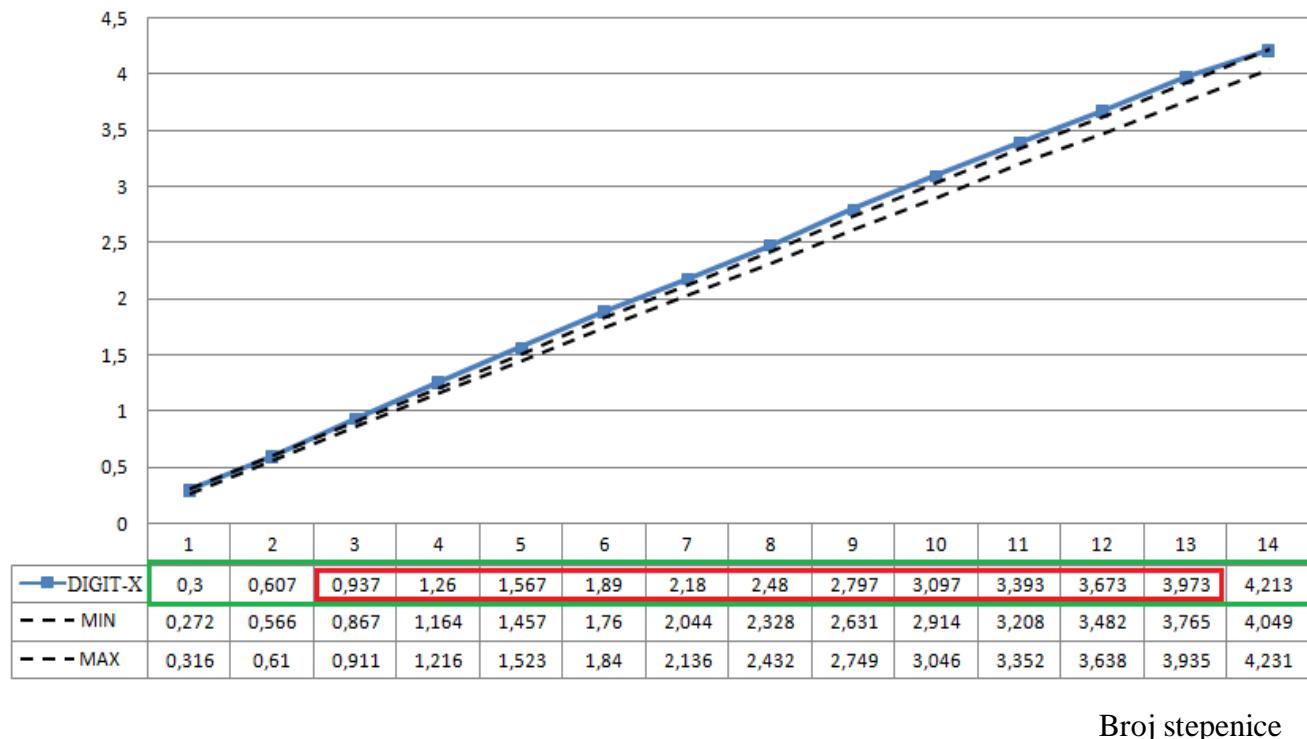


Slika 11. Usporedba referentnih vrijednosti etalona zacrnjenja sa vrijednostima zacrnjenja dobivenim mjeranjem zacrnjenja denzitometrom Digit-X (Xograph)

Iz grafa na slici 11. može se vidjeti da su stepenice 1,2 i 14 unutar tolerancija dobivenih uz etalon zacrnjenja, dok sve ostale stepenice nisu unutar tog tolerancijskog polja i označene su crvenom bojom. Kada se uzme u obzir da točnost denzitometra Digit-X (Xograph) varira od ± 0.05 tada denzitometar pokazuje vrijednosti koje odgovaraju referentnim vrijednostima stepeničastog etalona zacrnjenja s važećim certifikatom (označeno zelenom bojom) što dovodi do zaključka da denzitometar pokazuje ispravne rezultate.

Mjerenja su provedena slučajnim redoslijedom. Svaka stepenica etalona izmjerena je tri puta te je kao konačna vrijednost zacrnjenja uzeta srednja vrijednost od te tri vrijednosti. Mjerenja su provedena približno u centru svake stepenice etalona. Na grafu 4. prikazane su vrijednosti iz tablice 3. i tablice 4. kako bi se izmjerene vrijednosti zacrnjenja mogle usporediti sa referentnim vrijednostima zacrnjenja dobivenih od proizvođača etalona zacrnjenja.

Zacrnjenje (D)

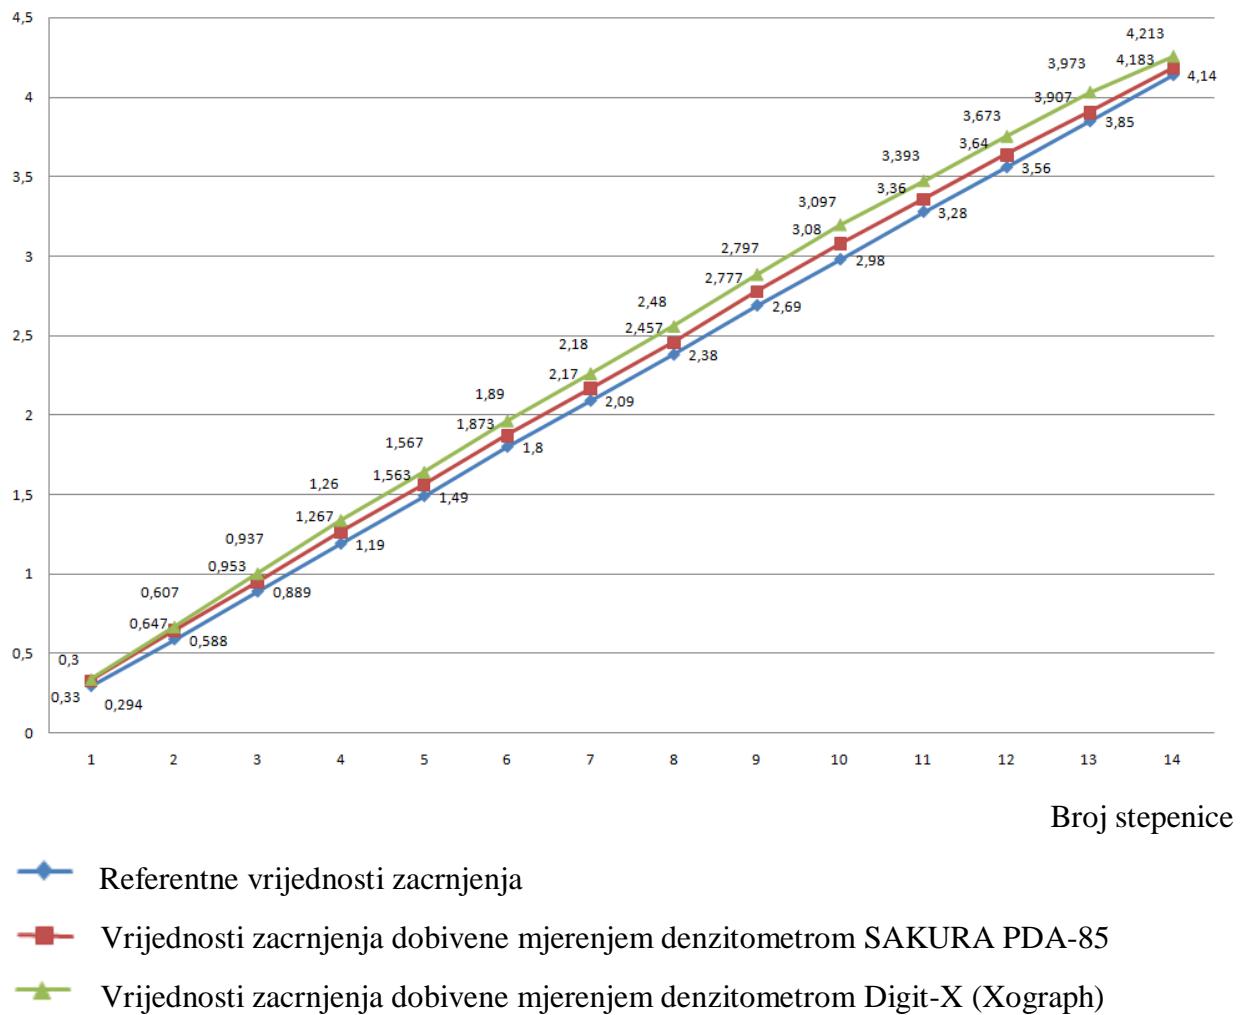

Slika 12. Usporedba referentnih vrijednosti zacrnjenja (AGFA) i izmjerenih vrijednosti zacrnjenja (SAKURA PDA-85 i Digit-X)

Iz grafa na slici 12. vidljivo je da rezultati mjeranja zacrnjenja odstupaju od rezultata dobivenih od proizvođača samog etalona. Razlika u rezultatima mogla bi se pripisati tome da proizvođač vjerojatno ima gotovo idealne uvjete prilikom mjerjenja zacrnjenja i vjerojatno puno precizniji denzitometar, no ovi denzitometri možda nisu toliko precizni budući da su u konstantnoj eksploataciji, ali su točni jer je odstupanje od referentnih vrijednosti gotovo jednako za svaku stepenicu zacrnjenja. Rezultati mjerjenja zacrnjenja denzitometrom SAKURA PDA-85 grafički prikazanih na slici 12. daju paralelnu liniju sa rezultatima proizvođača dok kod prikaza rezultata denzitometra digit-X dolazi do laganog zaobljenja što znači da odstupanje od referentnih vrijednosti nije konstantno.


Nakon mjerjenja AGFA stepeničastog etalona sa važećim certifikatom, mjerena su provedena i na AGFA stepeničastom etalonu starom 15-ak godina kako bi se vidjelo da li postoji kakva razlika u dobivenim rezultatima. Svaki stepeničasti etalon ima i svoje referentne vrijednosti. Referentne vrijednosti AGFA stepeničastog etalona s ne važećim certifikatom prikazane su u tablici 5.

Tablica 5. Referentne vrijednosti dobivene od proizvođača stepeničastog etalona (AGFA- sa ne važećim certifikatom)

AGFA (ne važeći certifikat)	
Stepenica	Referentna vrijednost
STEP 0	0.171
STEP 1	0.307
STEP 2	0.612
STEP 3	0.925
STEP 4	1.240
STEP 5	1.540
STEP 6	1.850
STEP 7	2.150
STEP 8	2.460
STEP 9	2.770
STEP 10	3.060
STEP 11	3.350
STEP 12	3.650
STEP 13	3.950
STEP 14	4.250

Referentne vrijednosti zacrnjenja iz tablice 5. grafički su prikazane na grafu 5.

Zacrnjenje (D)

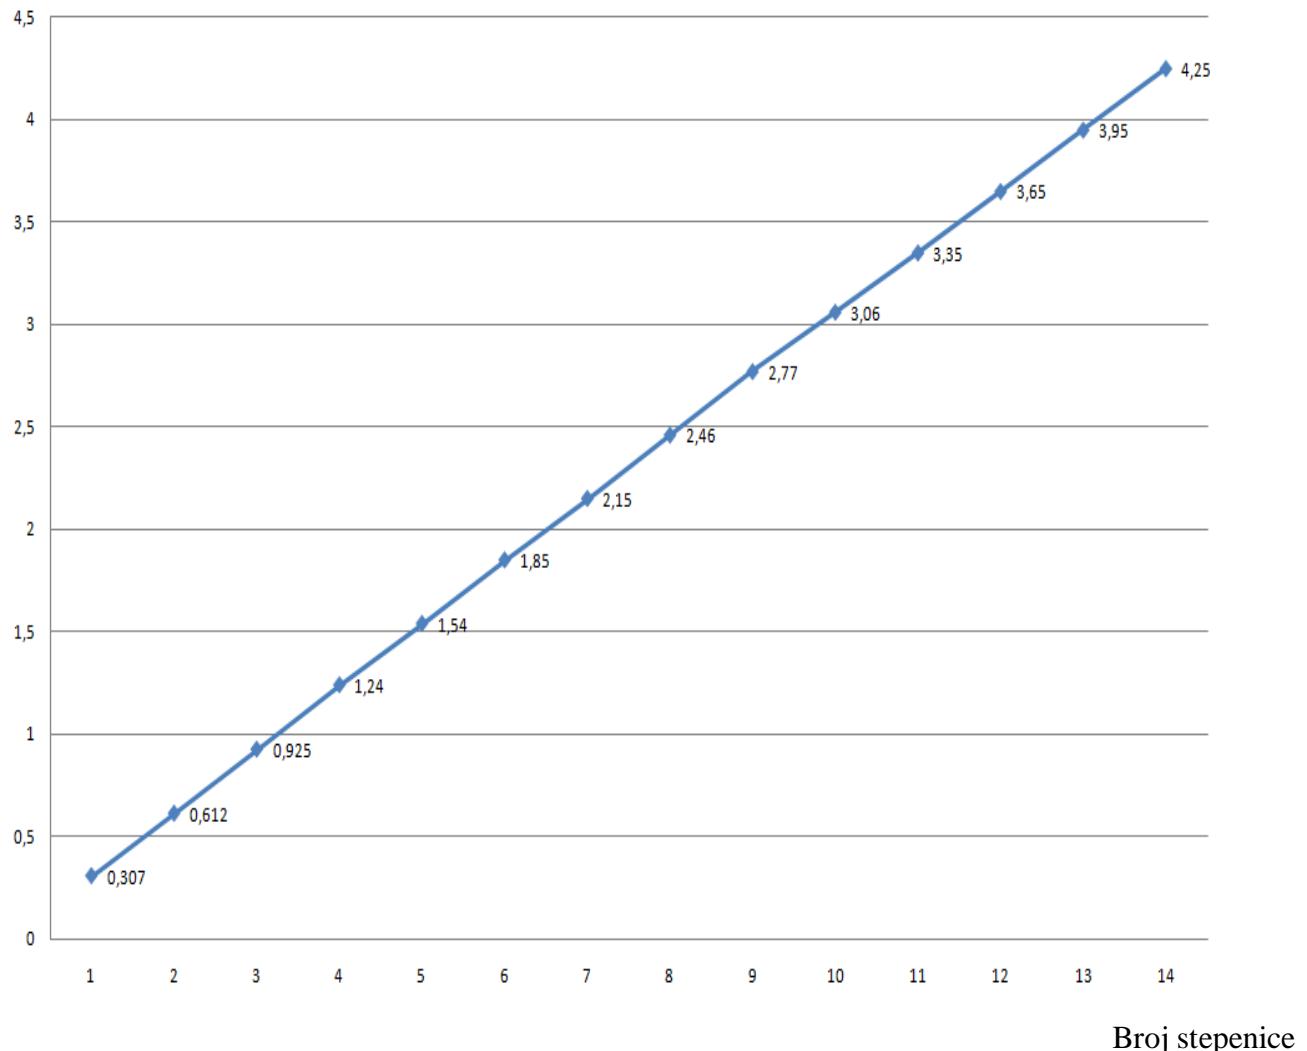

Slika 13. Grafički prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja (AGFA sa ne važećim certifikatom)

Iz grafa na slici 13. vidljivo je da se raspon od najniže vrijednosti zacrnjenja do najviše vrijednosti zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja mijenja linearno sa intervalima između stepenica od približno 0,3 što je bio i slučaj kod AGFA stepeničastog etalona s važećim certifikatom.


Mjerenja su provedena denzitometrom X-Rite 301-X na AGFA stepeničastom etalonu sa važećim certifikatom i na AGFA stepeničastom etalonu sa ne važećim certifikatom kako bi se dobivene rezultate moglo međusobno usporediti.

Rezultati dobiveni mjerjenjem zacrnjenja denzitometrom X-Rite 301-X AGFA stepeničastog etalona sa važećim i ne važećim certifikatom prikazani su u tablicama 6. i 7.

Tablica 6. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerjenjem denzitometrom X-Rite 301-X (AGFA - sa važećim certifikatom)

X-Rite-301X (AGFA - sa važećim certifikatom)							
Stepenica	1.mjerenje	2.mjerenje	3.mjerenje	Srednja vrijednost	Referentna vrijednost	Razlika referentne i srednje vrijednosti	Δ (%)
STEP 1	0.27	0.26	0.27	0.267	0.294	0.027	9.2
STEP 2	0.55	0.55	0.55	0.55	0.588	0.038	6.5
STEP 3	0.84	0.84	0.84	0.84	0.889	0.049	5.5
STEP 4	1.12	1.12	1.12	1.12	1.190	0.07	5.9
STEP 5	1.41	1.42	1.42	1.417	1.490	0.073	4.9
STEP 6	1.71	1.71	1.71	1.71	1.800	0.09	5
STEP 7	2.0	1.99	2.0	1.997	2.090	0.093	4.5
STEP 8	2.28	2.28	2.28	2.28	2.380	0.1	4.2
STEP 9	2.58	2.58	2.58	2.58	2.690	0.11	4.1
STEP 10	2.87	2.87	2.88	2.873	2.980	0.107	3.6
STEP 11	3.15	3.15	3.16	3.153	3.280	0.127	3.9
STEP 12	3.42	3.43	3.43	3.427	3.560	0.133	3.7
STEP 13	3.71	3.71	3.71	3.71	3.850	0.14	3.6
STEP 14	3.99	3.99	4.0	3.993	4.140	0.147	3.5

Zacrnjenje (D)

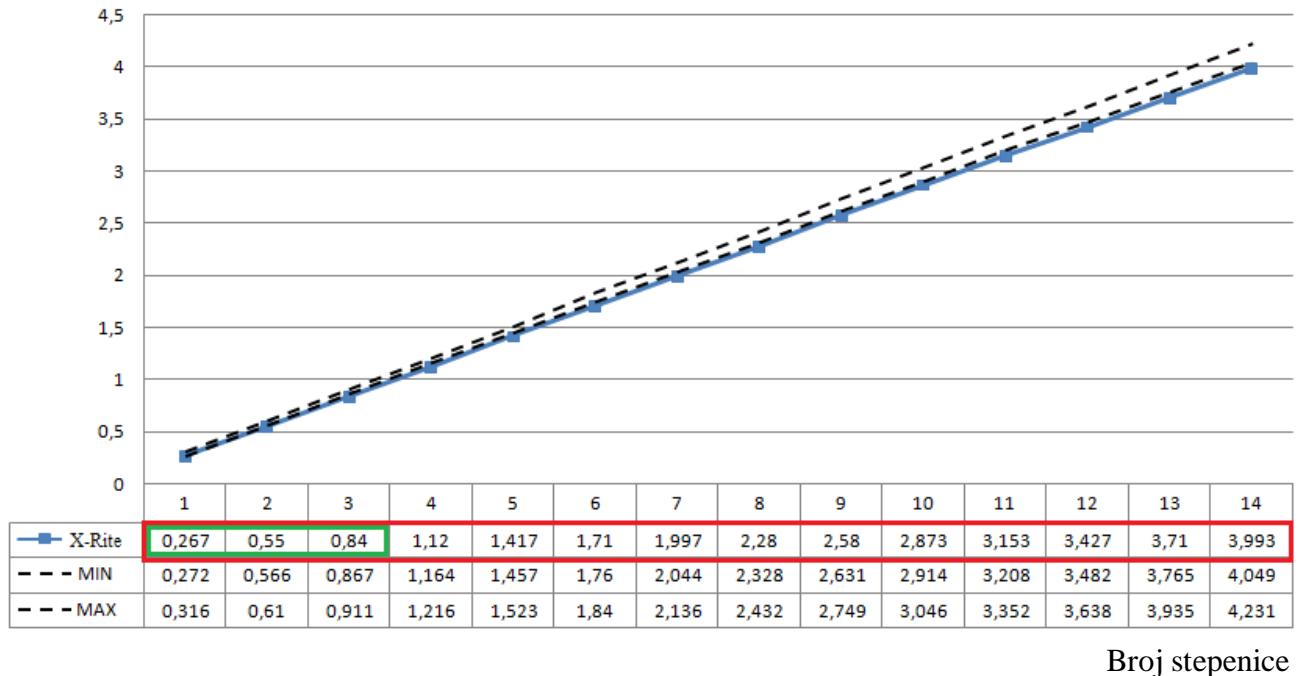

Slika 14. Dozvoljeno odstupanje referentne vrijednosti etalona od referentnih vrijednosti dobivenih od proizvođača etalona


Iz grafa na slici 14. vidljivo je da su sve izmjerene vrijednosti zacrnjenja denzitometrom X-Rite-301X van tolerancijskog polja etalona, a uzme li se u obzir točnost denzitometra koja varira od ± 0.02 samo na prve tri stepenice pokazuje ispravne rezultate. Budući da su mjerena provodena na etalonu zacrnjenja sa još uvijek važećim certifikatom i da je prethodnim mjeranjem denzitometrom Digit-X (Xograph) potvrđeno da pokazuje ispravne rezultate dolazi se do zaključka da denzitometar X-Rite-301X ne pokazuje ispravne rezultate.

Tablica 7. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerjenjem denzitometrom X-Rite 301-X (AGFA - sa ne važećim certifikatom)

X-Rite-301X (AGFA - sa ne važećim certifikatom)							
Stepenica	1.mjerenje	2.mjerenje	3.mjerenje	Srednja vrijednost	Referentna vrijednost	Razlika referentne i srednje vrijednosti	Δ (%)
STEP 1	0.27	0.27	0.27	0.27	0.307	0.037	12.1
STEP 2	0.57	0.57	0.56	0.567	0.612	0.045	7.4
STEP 3	0.86	0.86	0.86	0.86	0.925	0.065	7
STEP 4	1.16	1.16	1.16	1.16	1.240	0.08	6.5
STEP 5	1.45	1.45	1.46	1.453	1.540	0.087	5.6
STEP 6	1.75	1.74	1.74	1.743	1.850	0.107	5.8
STEP 7	2.03	2.03	2.03	2.03	2.150	0.12	5.6
STEP 8	2.33	2.34	2.34	2.337	2.460	0.123	5
STEP 9	2.64	2.66	2.64	2.647	2.770	0.123	4.4
STEP 10	2.91	2.92	2.91	2.913	3.060	0.147	4.8
STEP 11	3.18	3.19	3.18	3.183	3.350	0.167	5
STEP 12	3.49	3.49	3.49	3.49	3.650	0.16	4.4
STEP 13	3.75	3.75	3.75	3.75	3.950	0.2	5.1
STEP 14	4.0	4.0	4.02	4.007	4.250	0.243	5.7

Na grafu 7. prikazana je usporedba rezultata dobivenih mjerjenjem denzitometrom X-Rite 301-X sa referentnim vrijednostima AGFA stepeničastog etalona s važećim certifikatom, a na grafu 8. prikazana je usporedba rezultata dobivenih mjerjenjem denzitometrom X-Rite 301-X sa referentnim vrijednostima AGFA stepeničastog etalona s ne važećim certifikatom.


Zacrnjenje (D)

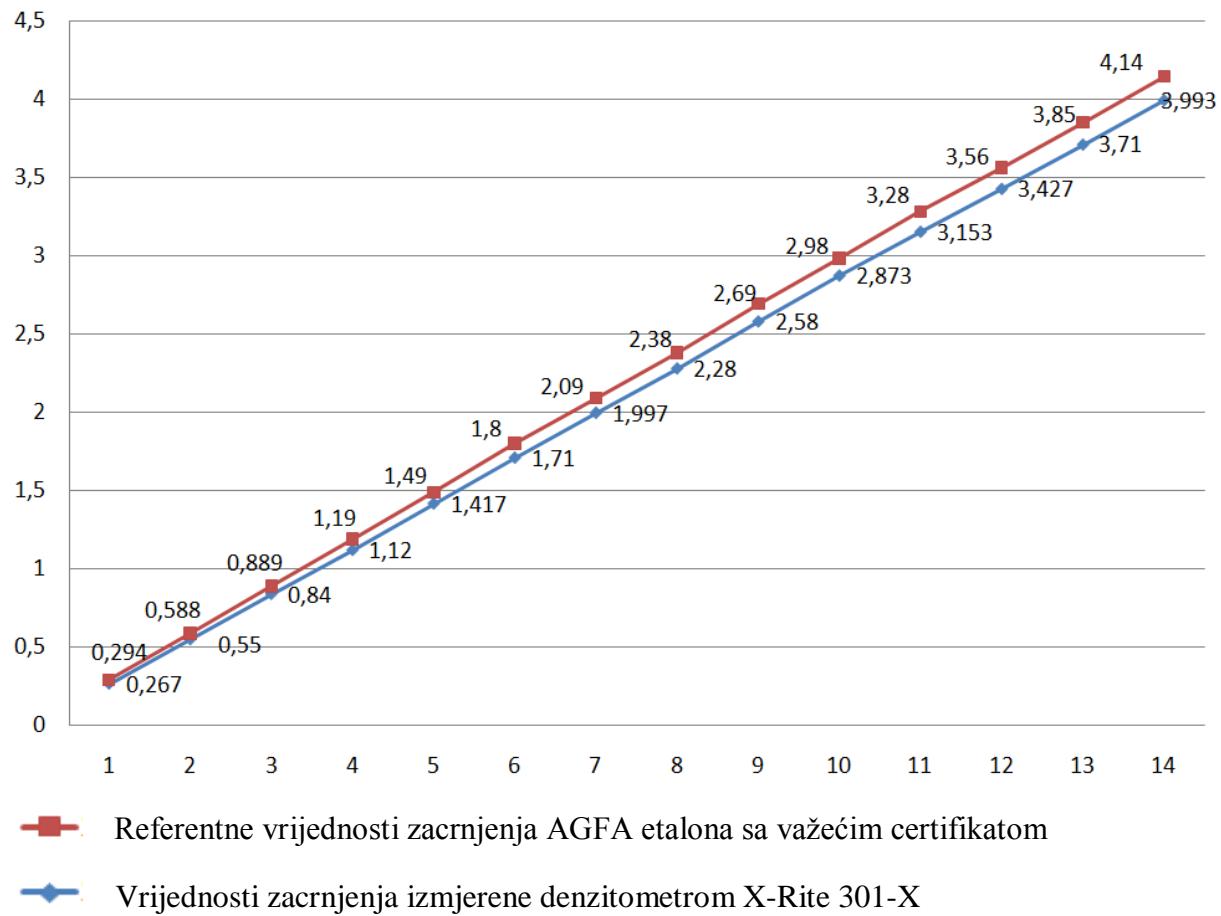

Slika 15. Prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja i vrijednosti dobivenih mjeranjem

Iz grafa na slici 15. može se vidjeti da su izmjerene vrijednosti zacrnjenja manje od referentnih vrijednosti i da su ova dva pravca gotovo paralelna što znači da je odstupanje od referentne vrijednosti gotovo jednako na svim stepenicama etalona zacrnjenja.

Zacrnjenje (D)

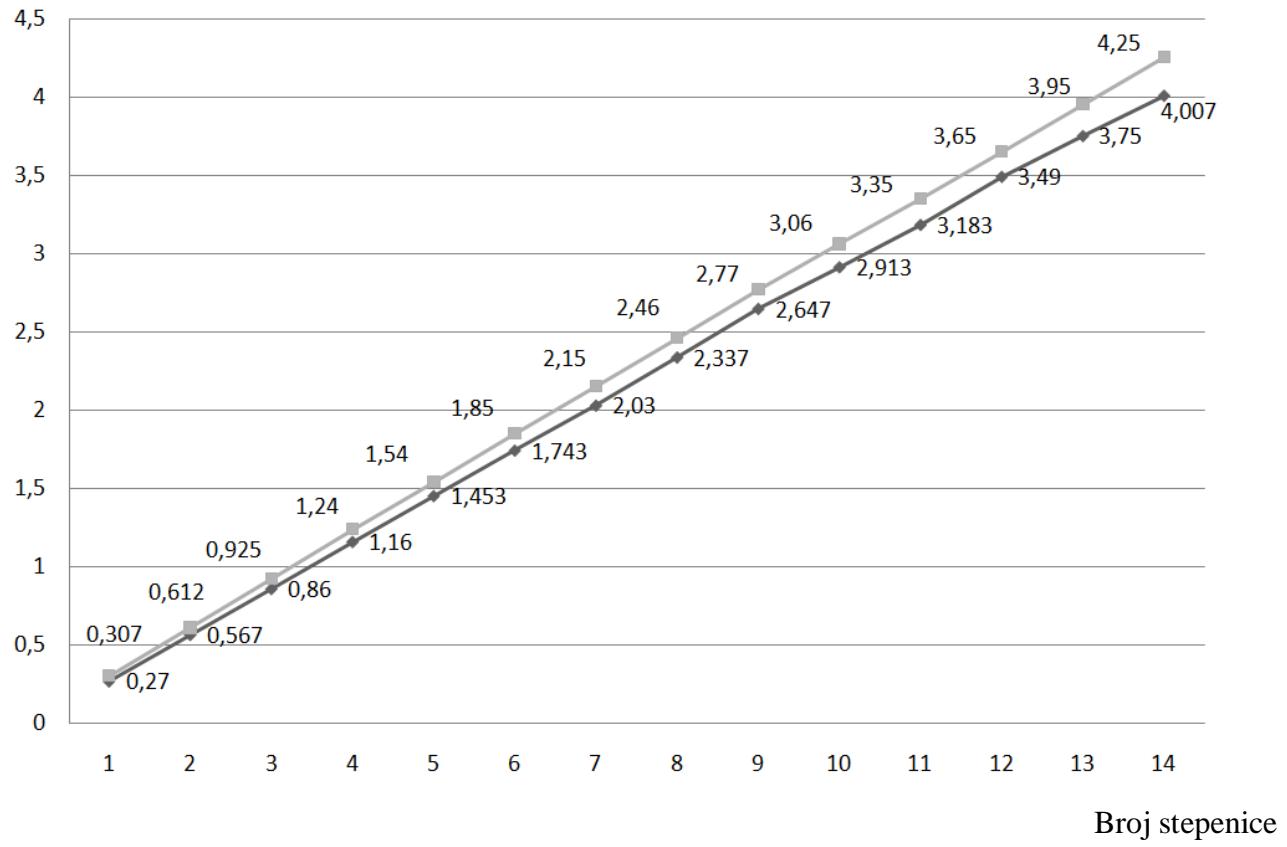

Slika 16. Prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja i vrijednosti dobivenih mjeranjem

- Referentne vrijednosti zacrnjenja AGFA etalona sa ne važećim certifikatom
- ◆ Vrijednosti zacrnjenja izmjerene denzitometrom X-Rite 301-X


Kao i iz grafa na slici 15. i iz grafa na slici 16. može se vidjeti da su izmjerene vrijednosti zacrnjenja isto manje od referentnih vrijednosti i što je gustoća zacrnjenja stepenice veća, veće je i odstupanje izmjerene vrijednosti od referentne vrijednosti. Usporedbom grafova na slikama 15. i 16. može se uočiti da je odstupanje izmjerenih vrijednosti zacrnjenja od referentnih vrijednosti AGFA stepeničastog etalona bez važećeg certifikata veće od odstupanja izmjerenih vrijednosti od referentnih vrijednosti AGFA stepeničastog etalona sa važećim certifikatom što je zapravo i očekivani rezultat s obzirom na starost tog etalona gdje je s godinama došlo do izbljeđivanja stepenica zacrnjenja na etalonu.

Mjerenja su provedena i na stepeničastom etalonu BAM iz 1998. godine. Kao i pri mjerenu na AGFA stepeničastom etalonu zacrnjenja mjerena na BAM stepeničastom etalonu izvođena su slučajnim redoslijedom. Referentne vrijednosti BAM stepeničastog etalona prikazane su u tablici 8. Za razliku od AGFA stepeničastog etalona BAM ima jednu stepenicu više sa rasponom zacrnjenja od 0 do 5.

Tablica 8. Referentne vrijednosti dobivene od proizvođača stepeničastog etalona (BAM)

BAM	
Stepenica	Referentna vrijednost
STEP 1	0.23
STEP 2	0.54
STEP 3	0.99
STEP 4	1.37
STEP 5	1.72
STEP 6	2.02
STEP 7	2.46
STEP 8	2.91
STEP 9	3.26
STEP 10	3.56
STEP 11	3.87
STEP 12	4.18
STEP 13	4.53
STEP 14	4.78
STEP 15	5

Zacrnjenje (D)

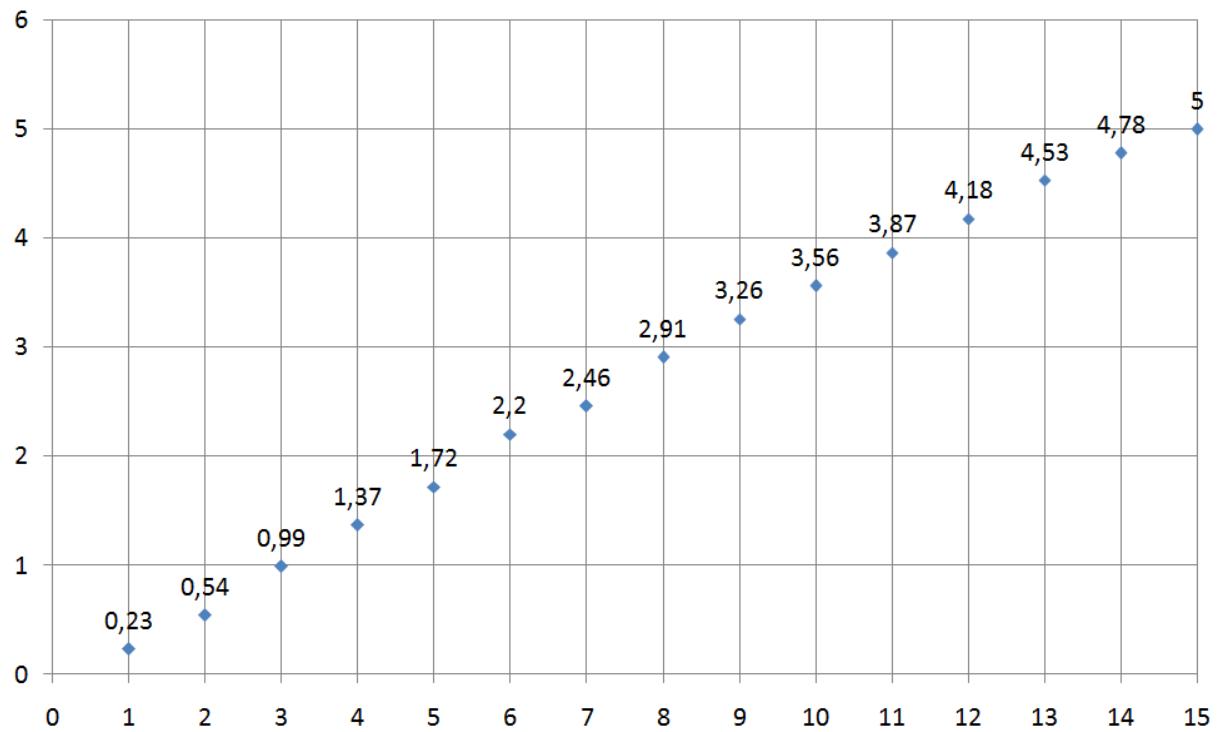

Slika 17. Grafički prikaz referentnih vrijednosti zacrnjenja (BAM)


Iz grafa na slici 17. vidljivo je da se raspon od najniže vrijednosti zacrnjenja do najviše vrijednosti zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja ne mjenja linearno pa ni graf nije linijski već su prikazane samo vrijednosti zacrnjenja na samim stepenicama etalona zacrnjenja jer vrijednosti koje bi prikazivala linija između stepenica zacrnjenja ne bi bile točne.

Referentne vrijednosti zacrnjenja dobivene od proizvođača stepeničastog etalona zacrnjenja uspoređene su sa vrijednostima dobivenim mjeranjem zacrnjenja tog istog etalona sa denzitometrom X-Rite 301-X. Rezultati mjeranja prikazani su u tablici 9.

Tablica 9. Vrijednosti zacrnjenja dobivene mjerenjem denzitometrom X-Rite 301-X

X-Rite 301-X						
Stepenica	1.mjerenje	2.mjerenje	3.mjerenje	Srednja vrijednost	Referentna vrijednost	Razlika referentne i srednje vrijednosti
STEP 1	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0,02
STEP 2	0.50	0.50	0.50	0.5	0.54	0,04
STEP 3	0.94	0.94	0.94	0.94	0.99	0,05
STEP 4	1.31	1.31	1.32	1.313	1.37	0,057
STEP 5	1.65	1.65	1.65	1.65	1.72	0,07
STEP 6	1.94	1.95	1.94	1.943	2.02	0,077
STEP 7	2.37	2.37	2.37	2.37	2.46	0,09
STEP 8	2.79	2.79	2.80	2.793	2.91	0,117
STEP 9	3.14	3.13	3.13	3.133	3.26	0,127
STEP 10	3.42	3.42	3.42	3.42	3.56	0,14
STEP 11	3.74	3.71	3.73	3.727	3.87	0,143
STEP 12	4.01	4.01	3.97	3.997	4.18	0,183
STEP 13	4.32	4.32	4.32	4.32	4.53	0,21
STEP 14	4.52	4.52	4.52	4.52	4.78	0,26
STEP 15	4.70	4.73	4.73	4.72	5	0,28

Zacrnjenje (D)

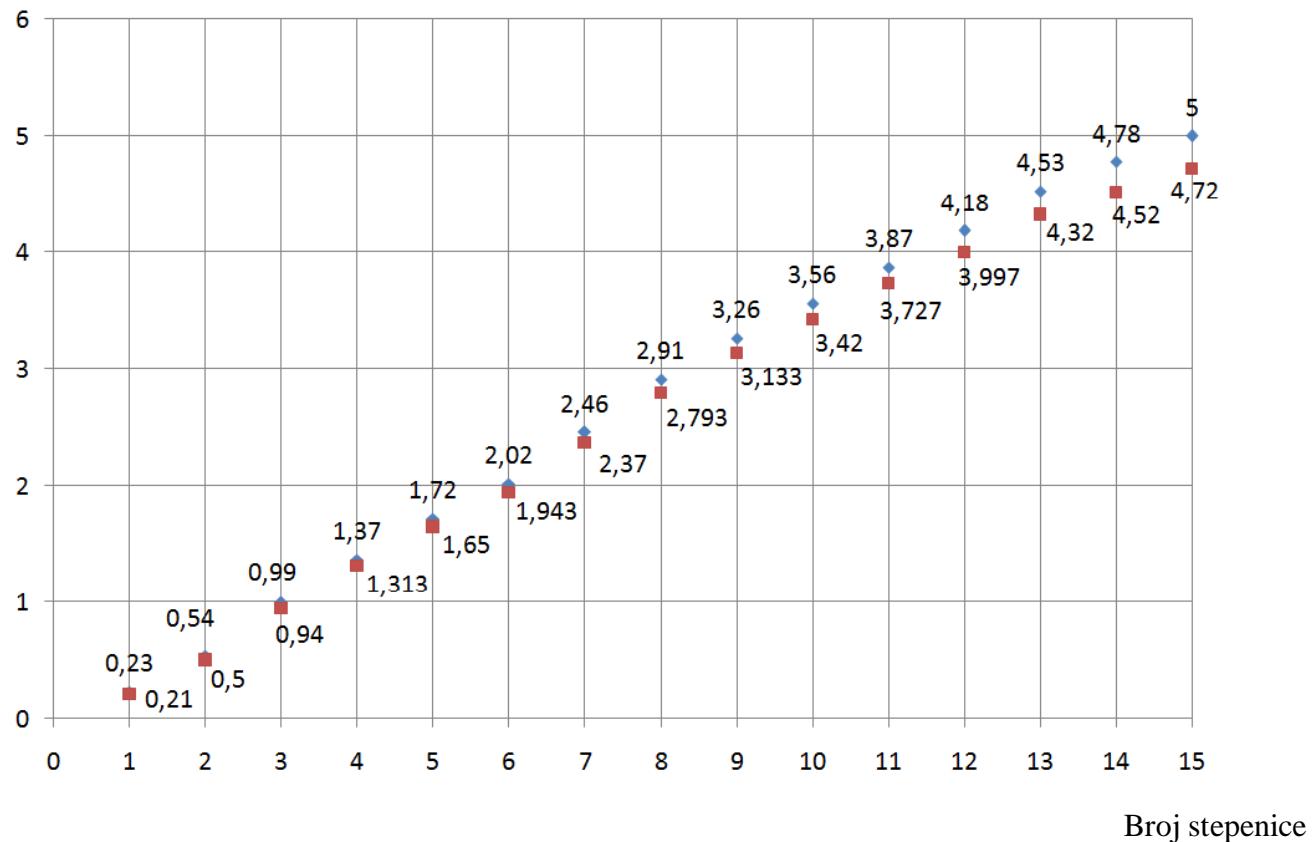


Slika 18. Usporedba referentnih vrijednosti (BAM) i vrijednosti dobivenih mjeranjem

- ◆ Referentne vrijednosti zacrnjenja (BAM)
- Vrijenosti zacrnjenja izmjerene denzitometrom X-Rite 301-X

Iz grafa na slici 18. vidljivo je da s porastom gustoće zacrnjenja izmjerena vrijednost svakom daljnjom stepenicom sve više odstupa od referentne vrijednosti.

Kako bi provjerili da li je zacrnjenje jednako na cijeloj površini stepenice zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja izvršena su po tri mjerena na istoj stepenici zacrnjenja i to na tri različite stepenice zacrnjenja na etalonu zacrnjenja. Mjesta na kojima su provođena mjerena na pojedinim stepenicama označena su brojevima 1, 2 i 3 kako je prikazano na slici 19. Stepenice zacrnjenja na kojima su mjerena provedena odabrana su na način da je jedna stepenica manjeg zacrnjenja, vrijednost zacrnjenja druge odabrane stepenice je približno $D=2$, te još jedna stepenica većeg zacrnjenja. Mjerena su izvršena na AGFA stepeničastom etalonu zacrnjenja sa i bez važećeg certifikata i na stepeničastom etalonu zacrnjenja BAM iz 1998. godine sa denzitometrom X-Rite-301X.

Denzitometar X-Rite-301X ima točnost od $\pm 0,02$, te ponovljivost od $\pm 0,01$.

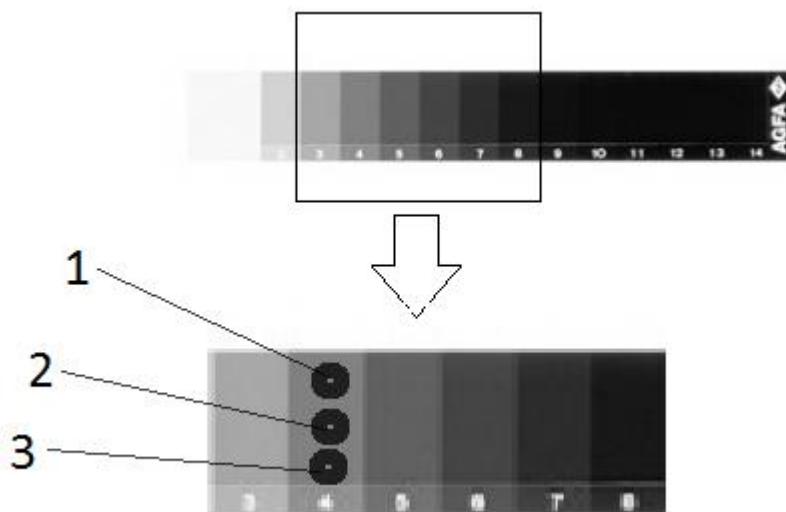

Slika 19. Područja mjeranja zacrnjenja na jednoj stepenici etalona zacrnjenja

Tablica 10. Rezultati mjerena za AGFA stepeničasti etalon sa važećim certifikatom

STEPENICA	2. STEP	7. STEP	13. STEP
referentna vrijednost	0,588	2,090	3,850
područje 1	0,55	2,0	3,72
područje 2	0,55	1,99	3,71
područje 3	0,55	2,0	3,72

Provedbom ovog mjerjenja vidljivo je da je ponovljivost denzitometra X-Rite-301X u dozvoljenom odstupanju iz čega se može zaključiti da je zapravo svejedno na kojem se području površine stepenice zacrnjenja provodi mjerjenje. Već je u prethodnim mjerjenjima utvrđeno da denzitometar X-Rite-301X ne pokazuje točne rezultate što se vidi i iz ovog mjerjenja budući da je jedino mjerenjem sedme stepenice zacrnjenja na stepeničastom etalonu s važećim certifikatom dobiven točan rezultat.

Tablica 11. Rezultati mjerjenja za AGFA stepeničasti etalon sa ne važećim certifikatom

STEPENICA	2. STEP	7. STEP	13. STEP
referentna vrijednost	0,612	2,150	3,950
područje 1	0,57	2,05	3,81
područje 2	0,57	2,04	3,77
područje 3	0,58	2,05	3,75

Iz tablice 11. vidljivo je da je zacrnjenje gotovo jednako na bilo kojem području stepenice ukoliko se radi o stepenicama manje gustoće zacrnjenja, ali na stepenici gdje je veća gustoća zacrnjenja dolazi do malih promjena u zacrnjenju ovisno na kojem području stepenice mjerimo. Usporedbom sa referentnim vrijednostima vidi se da je s godinama došlo do izbljeđivanja etalona koje je na manjim vrijednostima zacrnjenja jednoliko, a na većim vrijednostima zacrnjenja izbljeđivanje nije pravilno.

Tablica 12. Rezultati mjerjenja za BAM stepeničasti etalon

STEPENICA	2. STEP	6. STEP	11. STEP
referentna vrijednost	0,54	2,02	3,87
područje 1	0,50	1,95	3,74
područje 2	0,50	1,94	3,74
područje 3	0,50	1,93	3,69

Kod BAM stepeničastog etalona iz 1998. godine došao sam do istog zaključka kao i kod AGFA stepeničastog etalona približno iste starosti, dakle s povećanjem gustoće zacrnjenja izbljeđivanje postaje sve nepravilnije.

Kako bi doznali da li na dobivene rezultate mjerjenja zacrnjenja utječe i intezitet svjetlosti iluminatora mjerjenja su provedena pri maksimalnom intezitetu osvjetljenja kao i pri smanjenom intezitetu osvjetljenja iluminatora na AGFA stepeničastom etalonu zacrnjenja bez važećeg certifikata denzitometrom SAKURA PDA-85.

U tablici 13. Prikazani su rezultati mjerjenja zacrnjenja pri maksimalnom intezitetu svjetlosti iluminatora dobiveni mjerjenjem zacrnjenja denzitometrom SAKURA PDA-85.

Tablica 13. Rezultati mjerenja zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja sa ne važećim certifikatom pri maksimalnom intezitetu svjetlosti iluminatora

SAKURA PDA-85							
Stepenica	1.mjerenje	2.mjerenje	3.mjerenje	Srednja vrijednost	Referentna vrijednost	Razlika referentne i srednje vrijednosti	Δ (%)
STEP 1	0.19	0.18	0.19	0.187	0.171	0.016	9.4
STEP 2	0.53	0.45	0.46	0.48	0.307	0.173	56.4
STEP 3	0.78	0.76	0.76	0.767	0.612	0.155	25.3
STEP 4	1.12	1.08	1.09	1.097	0.925	0.172	18.6
STEP 5	1.40	1.38	1.41	1.397	1.240	0.157	12.7
STEP 6	1.69	1.69	1.69	1.69	1.540	0.150	9.7
STEP 7	1.98	1.98	2.00	1.987	1.850	0.137	7.4
STEP 8	2.31	2.31	2.31	2.31	2.150	0.160	7.4
STEP 9	2.63	2.62	2.62	2.623	2.460	0.163	6.6
STEP 10	2.89	2.90	2.90	2.897	2.770	0.127	4.6
STEP 11	3.18	3.18	3.19	3.183	3.060	0.123	4
STEP 12	3.47	3.47	3.51	3.483	3.350	0.133	3.97
STEP 13	3.71	3.72	3.73	3.72	3.650	0.070	1.9
STEP 14	4.01	4.01	4.00	4.007	3.950	0.057	1.44

Smanjeni intezitet svjetlosti dobiven je na način da je na maksimalnom intezitetu svjetlosti iluminatora denzitometar podešen na nulu, te je potenciometrom smanjivan intezitet svjetlosti iluminatora sve dok denzitometar nije pokazao vrijednost zacrnjenja od $D=0,5$, te je pri tome intezitetu svjetlosti denzitometar ponovno podešen na nulu. Iz matematičkog izraza za zacrnjenje izračunato je da je intezitet svjetlosti iluminatora smanjen tri puta, točnije 3,16 puta, u odnosu na maksimalni intezitet svjetlosti iluminatora.

$$D = \log_{10} \frac{I_0}{I}$$

$$D = 0,5$$

$$\frac{I_0}{I} = 1$$


$$0,5 = \log_{10} \Rightarrow 10^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{10} \Rightarrow 3,16$$

Dobiveni rezultati mjerena zacrnjenja pri smanjenom intezitetu svjetlosti iluminatora prikazani su u tablici 14. Mjerenja su također provedena denzitometrom SAKURA PDA-85 na istom stepeničastom etalonu zacrnjenja kako bi smo dobivene rezultate mogli usporediti.

Tablica 14. Rezultati mjerenja zacrnjenja na stepeničastom etalonu zacrnjenja sa ne važećim certifikatom pri smanjenom intezitetu svjetlosti iluminatora

SAKURA PDA-85							
Stepenica	1.mjerenje	2.mjerenje	3.mjerenje	Srednja vrijednost	Referentna vrijednost	Razlika referentne i srednje vrijednosti	Δ (%)
STEP 1	0.22	0.28	0.20	0.233	0.171	0.062	36.2
STEP 2	0.51	0.61	0.55	0.557	0.307	0.250	81.4
STEP 3	0.82	0.89	0.87	0.860	0.612	0.248	40.5
STEP 4	1.18	1.16	1.20	1.180	0.925	0.255	27.6
STEP 5	1.52	1.52	1.47	1.503	1.240	0.263	21.2
STEP 6	1.84	1.80	1.79	1.810	1.540	0.270	17.5
STEP 7	2.12	2.13	2.12	2.123	1.850	0.273	14.7
STEP 8	2.41	2.43	2.42	2.420	2.150	0.270	12.6
STEP 9	2.71	2.70	2.71	2.707	2.460	0.247	10
STEP 10	2.96	2.95	2.97	2.960	2.770	0.190	6.8
STEP 11	3.24	3.26	3.26	3.253	3.060	0.193	6.3
STEP 12	3.56	3.54	3.54	3.547	3.350	0.197	5.9
STEP 13	3.79	3.82	3.80	3.803	3.650	0.153	4.2
STEP 14	4.06	4.08	4.08	4.073	3.950	0.123	3.1

Zacrnjenje (D)

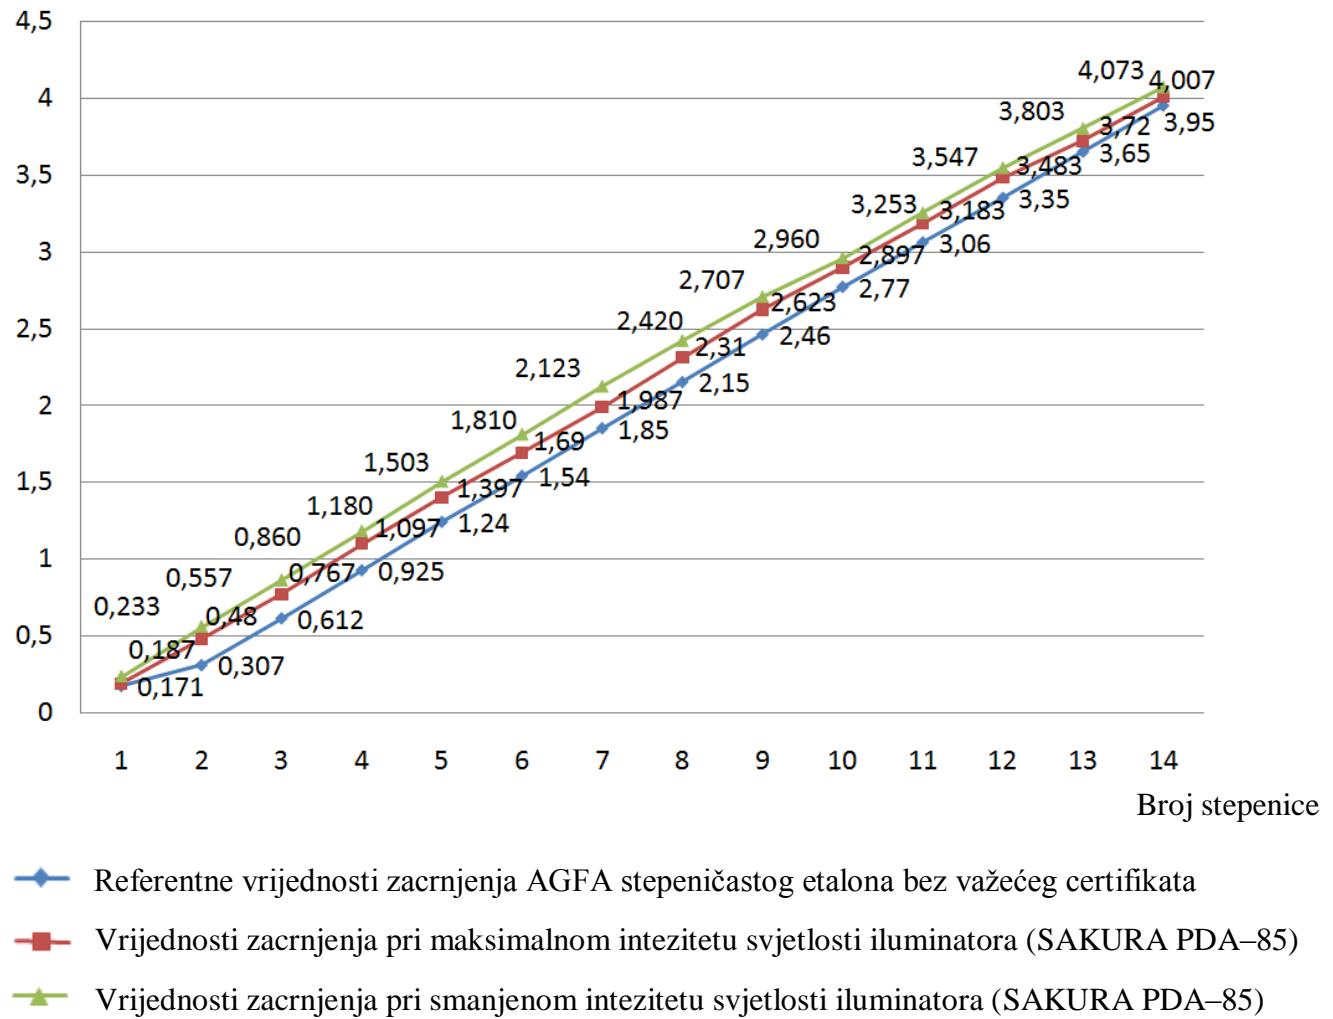

Slika 20. Usporedba rezultata mjerena zacrnjenja pri maksimalnom i smanjenom intezitetu svjetlosti iluminatora

Iz grafa na slici 20. vidljivo je da su vrijednosti zacrnjenja dobivene mjeranjem zacrnjenja denzitometrom SAKURA PDA-85 i pri maksimalnom i pri smanjenom intezitetu svjetlosti iluminatora veće od referentnih vrijednosti zacrnjenja AGFA stepeničastog etalona zacrnjenja bez važećeg certifikata. Pri smanjenom intezitetu svjetlosti iluminatora i intezitet zraka koji prolaze kroz rendgenski film odnosno stepeničasti etalon zacrnjenja je manji pa su samim time i vrijednosti zacrnjenja dobivene mjeranjem zacrnjenja veće.

Kao rezultat provođenja mjerena zacrnjenja izrađen je obrazac za provjeru denzitometra. Obrazac sadrži osnovne podatke o opremi koja je potrebana da bi se provjerila točnost mjerena denzitometra. Područje provjere mjerena zacrnjenja je $D \approx 1,5\text{--}3,5$ budući da je to područje zacrnjenja od najvećeg značaja u provođenju ispitivanja radiografskom metodom unutar metoda nerazornih ispitivanja.

U tablicu je potrebno unijeti rezultate mjerena. Mjerena je potrebno provesti tri puta i to slučajnim redoslijedom, te se nakon dobivenih rezultata mjerena matematički izračuna srednja vrijednost zacrnjenja. Referentne vrijednosti zacrnjenja dobivene su od proizvođača stepeničastog etalona zacrnjenja, te je u tablicu potrebno unijeti razliku između srednje vrijednosti zacrnjenja dobivene na temelju provedenih mjerena i referentnih vrijednosti zacrnjenja. Zatim se u svrhu lakše predodžbe podaci iz tablice prikažu grafički.

Iz tablice odnosno grafa može se zaključiti da li denzitometar prikazuje točne rezultate. Ukoliko je odstupanje srednjih vrijednosti zacrnjenja od referentnih vrijednosti zacrnjenja konstantno to se jednostavno vidi iz obrazca za provjeru denzitometra, te se pri provođenju mjerena to uzme u obzir.

Budući da se podešavanje denzitometra nužno mora izvršiti barem jedanput godišnje, obrazac ostaje kao trajan dokument koji je dostupan svakom ispitivaču, te nije potrebno da svaki ispitivač zasebno provjerava denzitometar.

OBRAZAC ZA PROVJERU DENZITOMETRA					
Osnovni podaci o opremi:					
DENZITOMETAR	Tip:	ILUMINATOR	Tip:	STEPENIČASTI ETALON	Proizvođač:
	Serijski broj:		Serijski broj:		Identifikacijski broj:
	Godina proizvodnje:		Minimalna luminancija (BS EN 25580:1992)		Valjanost certifikata:
	Deklarirano odstupanje: Točnost: \pm Ponovljivost: \pm		30 000 cd/m²		
Područje provjere zacrnjenja: D≈1,5 - 3,5					
Skica stepeničastog etalona					
STEP					
1. mjerjenje					
2. mjerjenje					
3. mjerjenje					
srednja vrijednost					
referentna vrijednost					
Δ					
Grafički prikaz srednje vrijednosti zacrnjenja i referentne vrijednosti zacrnjenja:					
Provjeru izvršio:	Potpis:	Datum:			

5. ZAKLJUČAK

Zacrnjenje je vrlo važan parametar pri ocjenjivanju radiograma stoga je vrlo važno imati što točnije izmjerenu vrijednost zacrnjenja. Da bi smo to postigli bitno je da imamo što točniji uređaj za mjerjenje zacrnjenja (denzitometar). Za podešavanje denzitometra koriste se stepeničasti etaloni zacrnjenja kod kojih je, kako je vidljivo i iz ovog diplomskog rada, važno da budu certificirani kako bi se osigurala sljedivost.

U radu su ustanovljeni sljedeći utjecajni čimbenici na provedbu postupka periodičke provjere denzitometra:

- starost i opće stanje referentnog stepeničastog etalona zacrnjenja,
- intenzitet iluminacije iluminatora,

Razlika između stepeničastog etalona sa važećim i ne važećim certifikatom sve je izraženija pri mjerenu većih gustoća zacrnjenja. Neovisno radi li se o stepeničastom etalonu zacrnjenja BAM ili AGFA bez važećih certifikata zaključak je isti, s povećanjem gustoće zacrnjenja dolazi do sve većih odstupanja izmjerenih vrijednosti od referentnih vrijednosti dobivenih od proizvođača etalona.

Svaka institucija ili firma, koja zbog prirode posla, ima potrebu mjeriti zacrnjenje trebala bi posjedovati stepeničasti etalon zacrnjenja bilo kojeg proizvođača s važećim certifikatom.

6. PRILOZI

I. CD-R disc

7. LITERATURA

- [1] Fakultet strojarstva u Banja Luci, <<http://www.blmasinac.com>>. Pриступљено 05. srpnja 2012.
- [2] Autor nepoznat, Oprema i pribor za radiografsku kontrolu
- [3] GE Measurement & Control ,<<http://www.ge-mcs.com>>. Pриступљено 05. srpnja 2012.
- [4] Wikipedia,<<http://en.wikipedia.org/wiki/Densitometry>>. Pриступљено 08. srpnja 2012.
- [5] Xograph,<<http://www.xograph.com>>. Pриступљено 08. srpnja 2012.
- [6] Xrite, <<http://www.xrite.com>>. Pриступљено 09. srpnja 2012.
- [7] Calibration Certificate Structurix certified denstep- X-Ray Film Step Tablet, GE Sensing & Inspection Technologies
- [8] BAM- Bundesanstalt fur Material-forschung und – prufung, Berlin, Geprufte Schwarzungstreppe fur die technische Radiographie
- [9] Norma BS EN 25580:1992 / ISO 5580:1985 - Specification for Minimum requirements for industrial radiographic illuminators for non-destructive testing, 15. lipanj 1992.